

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСС»



UA. TR. 047

УТВЕРЖДЕН
5В2.840.394-50 ПС-ЛУ

ДКПП 33.20.53.190
ДКПП 26.51.53-13.00

СИГНАЛИЗАТОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЗОНД-1-57

Паспорт

5В2.840.394-50 ПС

№ 347

1 Общие указания

1.1 Паспорт является эксплуатационным документом, определяющим комплектность сигнализатора полупроводникового ЗОНД-1 (далее – сигнализатор), его пригодность к эксплуатации и служит для внесения в него сведений, касающихся технического состояния сигнализатора при выпуске с предприятия-изготовителя и в процессе эксплуатации.

1.2 Правила заполнения и ведения паспорта:

- при записи в паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки;

- неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо;

- после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.3 Паспорт входит в комплект поставки сигнализатора и должен постоянно находиться с ним.

1.4 Перед эксплуатацией сигнализатора необходимо внимательно ознакомиться с его руководством по эксплуатации 5B2.840.394-50 РЭ.

1.5 Сигнализатор является средством измерительной техники и подлежит проверке при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации. Межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

2 Основные сведения об изделии

Наименование изделия: Сигнализатор полупроводниковый ЗОНД-1- 57.

Конструктивное исполнение ВА.

Обозначение изделия: 5B2.840.394- 53.

Заводской номер: 347.

Дата изготовления: 09.13г..

Наименование и почтовый адрес предприятия-изготовителя:

ПАО "РОСС".

Украина, 61017, г. Харьков, ул. Котлова, 129.

3 Основные технические данные и характеристики

3.1 Основные технические данные и характеристики сигнализатора приведены в руководстве по эксплуатации 5B2.840.394-50 РЭ.

4 Комплектность

4.1 Комплектность сигнализатора приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество, шт.	Заводской номер	Примечание
<u>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</u>				
5B6.451.615	Насадка	1	-	
5B8.392.504	Ключ	1	-	
5B5.087.153	Зарядное устройство ЗУ-10	1	<u>1098</u>	
5B5.170.329	Пульт настройки сигнализатора		-	
5B8.639.026	Амортизатор	1	-	Для выносного датчика
<u>КОМПЛЕКТЫ</u>				
5B4.175.402	Упаковка	1 комп.	-	
<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>				
5B2.840.394-50 ПС	Паспорт	1	-	
5B2.840.394-50 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	
5B5.087.153 ЭТ	Зарядное устройство ЗУ-10. Этикетка	1	-	
5B6.451.615 ЭТ	Насадка. Этикетка	1	-	
5B5.170.329 ЭТ	Пульт настройки сигнализатора. Этикетка		-	

Примечание – Пульт настройки сигнализатора 5B5.170.329 (с этикеткой 5B5.170.329 ЭТ) поставляется по отдельному заказу.

5 Свидетельство о приемке

Сигнализатор ЗОНД-1-57 5В2.840.394-53 заводской номер 347 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, технических условий ТУ У 00203016.003-96 5В2.840.394 ТУ и признан годным для эксплуатации.

МП ОТК
личная подпись

Начальник ОТК

расшифровка подписи

09.13г.
год, месяц, число

6 Свидетельство о поверке

Сигнализатор ЗОНД-1-57 5В2.840.394-53 заводской номер 347, внесенный в Государственный реестр СИТ Украины за № У651-12, на основании результатов поверки, произведенной ГП "Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации", признан годным и допущен к применению.

М П



Государственный поверитель

09.13 г.

7 Свидетельство об упаковывании

Сигнализатор ЗОНД-1- 57 5B2.840.394- 53 заводской номер 347
упакован ПАО "РОСС" согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

09.137

год, месяц, число

8 Гарантии изготовителя (поставщика)

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации сигнализатора – 18 месяцев со дня ввода сигнализатора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения сигнализатора – 12 месяцев.

Сигнализатор, у которого нарушены пломбы, к гарантийному ремонту не принимается.

8.2 Гарантии не распространяются на сигнализаторы, в которых для зарядки аккумуляторов потребитель использует зарядные устройства других типов.

8.3 Гарантии на гальванические элементы не распространяются.

9 Сведения о рекламациях

9.1 В случае отказа сигнализатора в работе или неисправности его в период действия гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- обозначение изделия, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;
- характер дефекта или неисправности;
- наличие у потребителя контрольно-измерительной аппаратуры и поверочных газовых смесей, указанных в руководстве по эксплуатации 5B2.840.394-50 РЭ.

Сигнализатор должен быть направлен в ремонт в комплекте с паспортом.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зарегистрированы в таблице 3.

Таблица 3

Дата	Краткое содержание предъявленной рекламации	Принятые меры

**ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність**

Реєстраційний № UA.047.D.00040-12

Термін дії з 24 лютого 2012 р. до 23 лютого 2015 р.

Публічне акціонерне товариство "РОСС"

(повна назва виготовлювача або його повноваженого представника)

ЕДРПОУ 00223237

резидента України, постачальника, код згідно з ЕДРПОУ, за наявності)

в особі директора Сазонова Олександра Захаровича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, адреса, контактний телефон)

Україна, 61017, м. Харків, вул. Котлова, 129, тел./факс: (057) 751-93-87

підтверджує, що продукція Сигналізатори напівпровідникові ЗОНД-1

(повна назва обладнання або захисних систем)

що виготовляються серійно з 24.02.2012 р.

яка виготовляється згідно з Технічними умовами ТУ У 00203016.003-96
5B2.840.394 ТУ

(назва й позначення документації виготовлювача)

відповідає вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах згідно з ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.6

(назва й позначення нормативних документів, за наявності)

Технічна документація відповідно до вимог цього Технічного регламенту є в наявності.

Сертифікат відповідності виданий Державним випробувальним сертифікаційним

(назва й місцезнаходження уповноваженого органу)

центром вибухозахищеного та рудникового обладнання (ДВСЦ ВО),

83052, м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, 17,

№ UA.TR.047.C.0040-12 від 24.02.2012 р.

(номер сертифіката відповідності, дата реєстрації, термін дії)

Декларацію складено під повну відповідальність виготовлювача/уповноваженого представника / постачальника.

Директор
(посада)

(підпис)

О.З. Сазонов
(ініціали та прізвище)

24 лютого 2012 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в реєстрі ДВСЦ ВО
Дійсність декларації можна перевірити за тел. (062) 345 04 17
або на сайті www.tcsexee.org

Керівник органу з оцінки відповідності ДВСЦ ВО

А.С. Погорельський


Сигнализаторы взрывозащиты

СИГНАЛИЗАТОРЫ

СИГНАЛИЗАТОРЫ

Внимание! В результате совершенствования сигнализатора возможны незначительные конструктивные и схемные изменения, не влияющие на взрывозащищенность и технические характеристики сигнализатора и которые могут быть не отражены в эксплуатационной документации

ВНИМАНИЕ! В результате совершенствования сигнализатора возможны незначительные конструктивные и схемные изменения, не влияющие на взрывозащищенность и технические характеристики сигнализатора и которые могут быть не отражены в эксплуатационной документации

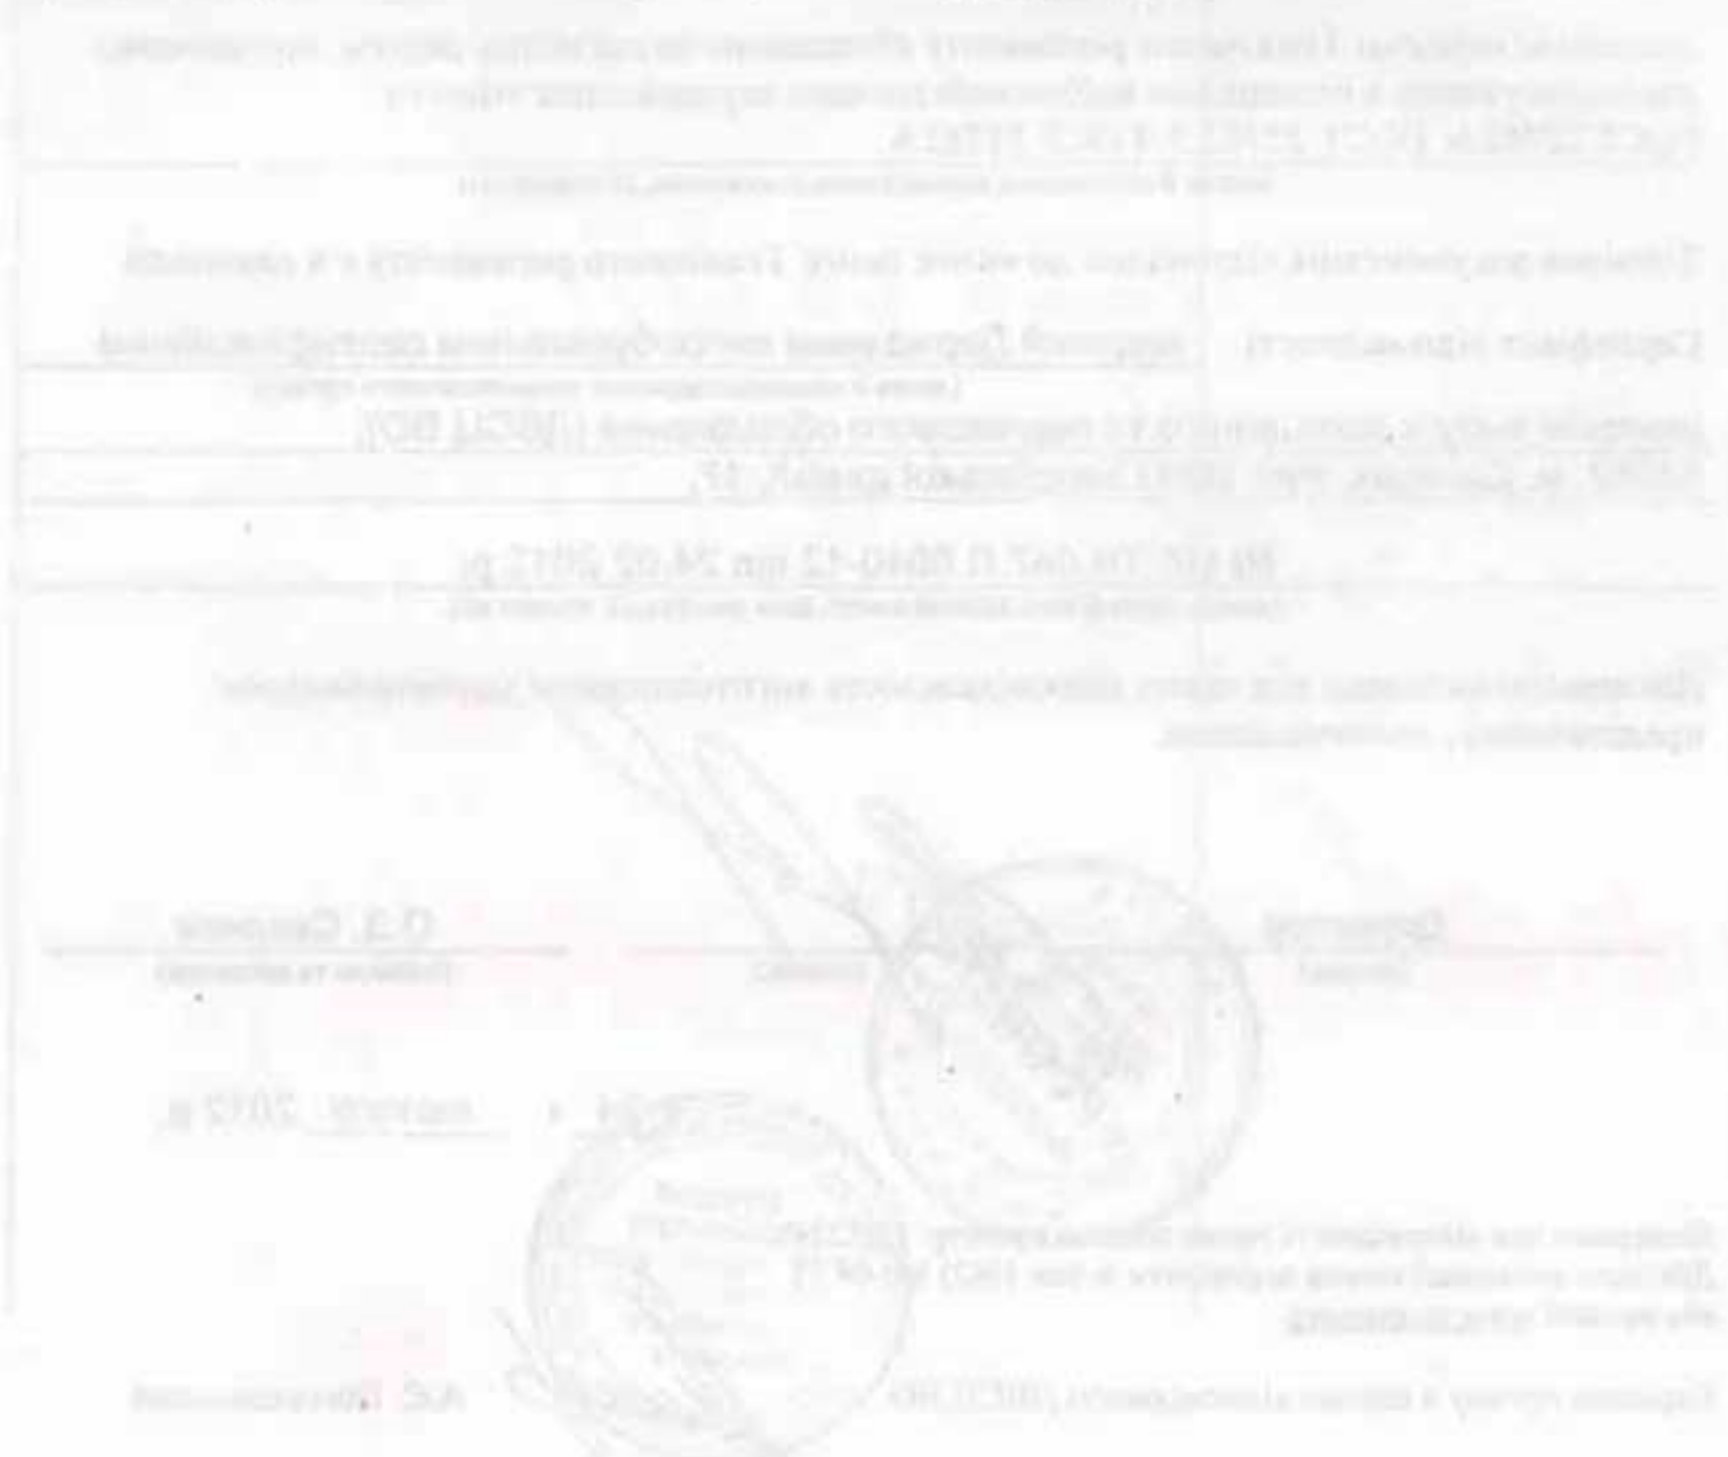

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСС"



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗУ-10

Этикетка

5B5.087.153 ЭТ

1 Основные технические данные

Напряжение питания, В

(220⁺²²
-33)

Частота, Гц

50 ± 1

Мощность, потребляемая от сети переменного
тока, ВА, не более

10

Габаритные размеры, мм, не более

65 × 90 × 90

Масса, кг, не более

0,15

2 Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения – 1 год с момента изготовления.

3 Свидетельство о приемке

Зарядное устройство ЗУ-10 5B5.087.153 заводской номер 1098
изготовлено в соответствии с действующей конструкторской документацией и
признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления 09.13г.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

09.13г.
год, месяц, число